

**ΠΡΟΣ:** ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**ΘΕΜΑ:** 2<sup>η</sup> ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ

<b>Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου</b>	<b>ANTISEL ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.</b>
<b>Ταχυδρομική Διεύθυνση</b>	<b>ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA – 570 01 ΘΕΡΜΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ</b>
<b>Υπεύθυνος σύνταξης</b>	<b>Ειρήνη Καρέτσου</b>
<b>Υπεύθυνος Επικοινωνίας</b>	<b>Μόσχου Αρχοντία</b>
<b>Τηλέφωνο</b>	<b>2310 322 525</b>
<b>Φαξ</b>	<b>2310 321 912</b>
<b>Email</b>	<b>antisel@antisel.gr</b>

Αγαπητές/οί κυρίες/οί,

Αναφορικά με την από πρόσκληση για την διενέργεια 2<sup>ης</sup> δημόσιας διαβούλευσης προμήθειας προμήθεια ψυχόμενης φυγοκέντρου, σας παραθέτουμε την προτεινόμενη τροποποίηση των προδιαγραφών.

Προτείνουμε η **προδιαγραφή 4 να μετατραπεί από:**

«Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή 8 θέσεων και τους αντίστοιχους υποδοχείς για φυγοκέντρηση 136 σωληναρίων (12 × 75 mm), μέγιστης ταχύτητας περιστροφής (RPM): 3500min<sup>-1</sup>, με φυγόκεντρη δύναμη 2850×G. Να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης-αφαίρεσης της κεφαλής χωρίς δυσκολία»


**Σε:** «Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή 4 θέσεων, με τα εξαρτήματα και τους αντίστοιχους υποδοχείς για φυγοκέντρηση τουλάχιστον 108 σωληναρίων (12 × 75 mm), μέγιστης ταχύτητας περιστροφής (RPM): 3500min<sup>-1</sup>, με φυγόκεντρη δύναμη 2850×G. Να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης-αφαίρεσης της κεφαλής χωρίς δυσκολία, με το πάτημα ενός πλήκτρου και χωρίς τη χρήση εργαλείων»  
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους προμηθευτές στα πλαίσια του υγειούς ανταγωνισμού

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Για την ANTISEL ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου  
Υπεύθυνος πελατών

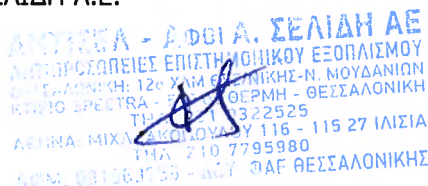

ANTISEL - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων  
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA - 570 01 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ: 2310 322525  
ΑΣΤΡΑ ΜΙΧΗΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ  
ΤΗΛ: 210 7795980  
ΦΑΞ: 032191235 - ΔΟΥ ΦΑΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ