

Προς  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Θεσσαλονίκη, 30/09/2019


**Θέμα:** Προτάσεις της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε. – MEDITECK SYSTEMS για την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ».

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της ανάρτησης σας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, προς δημόσια διαβούλευση του υπ' αριθμ. πρωτ. 18812/21-5-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Συσκευές και όργανα έγχυσης». προκειμένου να συνταχθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω ειδών, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας για τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Με τιμή,

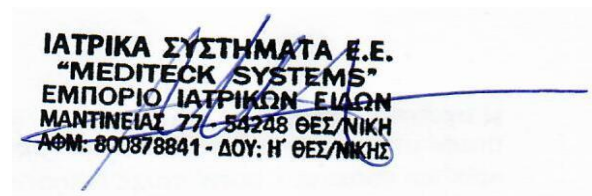

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε.  
MEDITECK SYSTEMS

**ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε. - "MEDITECK SYSTEMS"**

Μαντινείας 77, 54248, Θεσσαλονίκη  
Τ. 2313 064133 F. 2313 092559 E. info@mediteck.gr  
ΑΦΜ: 800878841, ΔΟΥ: Η' Θεσσαλονίκης  
[www.mediteck.gr](http://www.mediteck.gr)

### 1. **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Να φέρει Υ, ενσωματωμένη διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής για προστασία από ελεύθερη ροή.

Πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής δεν εμφανίζεται σωστά η λειτουργία της διπλής βαλβίδας.

Η πρώτη λειτουργία είναι 1. Αντεπιστροφή των υγρών και η δεύτερη 2. προστασία από την ελεύθερη ροή.

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:**

*«Να φέρει Υ, ενσωματωμένη διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής και προστασίας από την ελεύθερη ροή.»*

### 2. **Μ.Ε.Θ.**

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ογκομετρικές αντλίες, (μονές).

Να φέρουν λαβή ασφαλούς μεταφοράς.

Για να υπάρχει όφελος από την ύπαρξη της λαβής ασφαλούς μεταφοράς – ταχύτητα σε διακομιδές, θα πρέπει η λαβή να είναι ενσωματωμένη, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση να τοποθετηθεί εξωτερική λαβή στην αντλία για να μεταφερθεί ο ασθενής.

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:**

*«Να φέρουν ενσωματωμένη λαβή ασφαλούς μεταφοράς.»*

### 3. **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΘ**

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Συσκευή έγχυσης μήκους >2,5m που να προσαρμόζεται σε ηλεκτρονική αντλία σύριγγας, μικρών διαστάσεων και βάρους.

Θεωρούμε ότι το μήκος της συσκευής >2,5m είναι πολύ μεγάλο για αντλία σύριγγας. Σύνηθες μήκος είναι τα 2m, μήκος το οποίο προτείνουμε να ζητηθεί.

### **ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ρυθμός έγχυσης από 0,1 έως 1200 ml/h με βήμα ανά 0,1 ml/h.

Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης ανοικτού αγγείου, με δυνατότητα ρύθμισης ροής 0,1-5 ml/h.

Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης συναγερμού φραγής.

Οι προδιαγραφές αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το αναλώσιμο υλικό, αλλά με τις αντλίες.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

*Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να μεταφερθούν στις προδιαγραφές της αντλίας σύριγγας.*

### **4. ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ**

Προτείνουμε να προστεθεί προδιαγραφή για λαβή ασφαλούς μεταφοράς όπως και στις ογκομετρικές αντλίες.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:**

*«Να φέρουν ενσωματωμένη λαβή ασφαλούς μεταφοράς.»*